

Passformular Lagooni Junior XS

Dealer	
Berater	
Lieferadresse	
Bezugsnummer	
Telefonnummer	
Email	
Kunde	



Haben Sie Fragen während des Passes?
Rufen Sie uns an unter +31 (0)174-281551

Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus. Bei fehlenden Daten liegt die Verantwortung bei der Partei, die das Formular ausgefüllt hat.

SB: Sitzbreite SH: Sitzhöhe
ST: Sitztiefe USL: Unterschenkellänge

- = Diese Teile werden ausgewählt, wenn eine Basiskonfiguration vorgenommen werden muss.

Rahmen

Wählen Sie 1 Rahmentyp aus, verwenden Sie das Flussdiagramm-Modellauswahltool, wenn die Auswahl des Rahmentyps nicht klar ist.

- Rahmen Junior XS: Rahmen für die kleinsten Größen.
- Ein Dusch-Toiletten-Rollstuhl Junior XS kann nicht über eine Toilettenschüssel gefahren werden.

* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.

- **CFRA07** ☐ **Frame Junior XS** mit Höhe- und Rückenlehnenverstellung
- AFRA11** ☐ Andere Rahmenfarbe
- CFRA04** ☐ Sonderbau Rahmen *

Bemerkungen:

Räder

◦ Bei 24-Zoll-Rädern beträgt der Sitzhöhenbereich: 53 cm (bei einem Sitzkissen von 6 cm). Die Sitzhöhe wird vom Boden bis zur Oberkante des Sitzes gemessen.

- CWIE20-75** ☐ 20" XCore Räder und 75 mm Vorderräder
- **CWIE24-100** ☐ 24" XCore Räder und 100 mm Vorderräder
- CWIE26-125** ☐ 26" Speichenräder und 125 mm Vorderräder
- AWIE10** ☐ Demontage Greifreifen
- CWIE02A** ☐ Gummi-überzogener Handlauf 20"
- CWIE02B** ☐ Gummi-überzogener Handlauf 24"
- CWIE02C** ☐ Gummi-überzogener Handlauf 26"
- AWIE11** ☐ Greifreifen fest an den Rädern montiert (nicht möglich für 26" Räder)
- CWIE12** ☐ Greifreifen mit Tetranops, Satz
- CWIE12L** ☐ Greifreifen mit Tetranops, links
- CWIE12R** ☐ Greifreifen mit Tetranops, rechts

Bemerkungen:

Bremsen

- CREM01SET ☐ Kniehebelbremsen
- CREM02SET ☐ Bremsen verlängert
- CREM06SET ☐ Scherebremsen

Bemerkungen:

Sitz


- Breite: 30 / 32 / 34 / 36 cm
- Standard dicke des Sitzes: 6 cm
- Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Plätalon, geeignet für Dekubitus.
- Eigenschaften von Plätalon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.

* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.


- CZIT01 ☐ Sitz mit Polyethern und Neopren oder Plätalon *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CZIT07 ☐ Füllstück des Sitzes
- CZIT08 ☐ Beinabduktion nach Maß *
- AZIT01E ☐ Zusätzliche Anpassungen des Sitzes *

Beispiele


Ausschnitt Vorne/Hinter
Form: Konisch




Ausschnitt Mitte/anders
Form: Oval




Ausschnitt Vorne/Hinter
Form: Schlüsselloch




Ausschnitt Links/Rechts
Form: Oval



Ausschnitt Vorne/Hinter
Form: gerader Schlitz



Ausschnitt Vorne
Form: Ellipse



Geben Sie unten die Maße (cm) der Aussparung an. Ein Ausschnitt auf der linken oder rechten Seite ist gegen Aufpreis möglich. Weicht die Lage/Form (z. B. Sitzkeil) von den untenstehenden Beispielen ab, fügen Sie bitte eine Maßzeichnung bei.

Die Felder mit einem * sind **ERFORDERLICH**.

* A:	
* B:	
* C:	
* D:	
* E:	
F:	
* Lage der Aussparung:	
* Form der Aussparung:	

(<6 cm nicht möglich)

Bemerkungen:

Rückenlehnenrohr

- Die Breite des Rückenlehnenbügels entspricht der Breite der Sitzfläche.
- Die Standardhöhe eines Rückenlehnenbügels beträgt 48 cm.

- **CRUG01** ☐ Rückenlehnenbügel
- CRUG01-M** ☐ Rückenlehnenbügel nach Maß *

Bemerkungen:

Rückenlehne Bezug

- Die Standardhöhe eines Rückenlehnenbezugs beträgt 30 cm.
- Bei Wahl einer gepolsterten Rückenlehne gilt: Sitztiefe + 3 cm.
- Bei einer „normalen“ gepolsterten Rückenlehne gilt: Breite der gepolsterten Rückenlehne = Rückenlehnenbügel + 2 cm.
- Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Plätalon, geeignet für Dekubitus.
- Eigenschaften von Plätalon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.

* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.

- **CRUG12** ☐ Rückenlehne Segeltuch bisonyl schwarz
- CRUG01B** ☐ Rückenlehne gepolstert mit Polyethern und **Neopren oder Plätalon** *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CRUG01BZU** ☐ Rückenlehne mit Seitenpelotte gepolstert mit Polyethern und **Neopren oder Plätalon** *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CRUG01K** ☐ Rückenlehne gepolstert Schalenform gepolstert mit Polyethern und **Neopren oder Plätalon***
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau

Bemerkungen:

Armstütze

▫ Die Armstütze sind wegschwenkbar und abnehmbar.

▫ Die Höhe der Armstütze wird von der Oberkante des Sitzes bis zur Oberkante der Armlehne gemessen.

▫ Für kürzere und niedrigere Armstütze können Sie sich für eine Junior-Armstütze (siehe Registerkarte "Maßblatt") oder eine Armstütze entscheiden, die nach Maß angefertigt werden muss.

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.*

- **CARM03-15** ☐ Junior Armstütze gerade H15 cm
- **CARM03-18** ☐ Junior Armstütze gerade H18 cm
- CARM01** ☐ Armstütze einfach gebogen H23 cm
- CARM02** ☐ Armstütze verstärkt H23 cm
- CARM04** ☐ Armstütze nach Maß *
- CARM09** ☐ Armstütze horizontale biegung vorne
- AARM02E** ☐ Zusätzliche Arbeit der Armstütze *
- ☐ Keine Armstütze

Bemerkungen:

Armlehne

▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Plätalon, geeignet für Dekubitus.

▫ Eigenschaften von Plätalon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.*

- **CARM05** ☐ Armlehne PU
- CARM06** ☐ Armlehnenpolsterung mit Polyethern und Neopren oder plätalon *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- AARM06E** ☐ Zusätzliche Arbeit der Armlehne *
- ☐ Keine Armlehne

Bemerkungen:


Beinstützen und Fußstützen

▫ *Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus.*

▫ *Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.*

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.*

- **CVOE13** ☐ Einstück Fußbrett, gepolstert
○ Neopren: Schwarz
○ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CVOE10** ☐ Einstück Fußbrett, gepolstert klappbar
○ Montage auf Fußbrett, klappbar nach links
○ Montage auf Fußbrett, klappbar nach rechts
○ Montage auf Rahmen, klappbar nach hinten
○ Neopren: Schwarz
○ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- AVOE01E** ☐ Zusätzliche Anpassungen der Fußstützpolsterung *
- ☐ Keine Beinstützen und/oder Fußstützen



Toilettenschüsselhöhe - A (cm):

Unterseite des Sitzes - B (cm):

Unterschenkelhöhe - C (cm):

Bemerkungen:

Anti-Kipp

▫ *In Kombination mit einem passiven oder aktiven Hebezeug wird eine Kippsicherung empfohlen.*

CATI01 ☐ Antikippsystem mit Fußpedal

Bemerkungen:

Kopfstütze

▫ *Wird eine Kopfstütze gewählt, empfiehlt sich die Wahl einer gepolsterten Rückenlehne.*

▫ *Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus.*

▫ *Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.*

- CSTE02** ☐ Kopfstütze gepolstert **neopren oder platilon**
○ Neopren: Schwarz
○ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CSTE03K** ☐ Kopfstütze PU **Klein**
- CSTE03MG** ☐ Kopfstütze PU **Mittelgroß**

Bemerkungen:

Seitliche Unterstützung

▫ *Beckengurtlänge: vom linken Einstellknopf für den Rückenwinkel bis zum rechten Einstellknopf für den Rückenwinkel.*

▫ *Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Plätalon, geeignet für Dekubitus.*

▫ *Eigenschaften von Plätalon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.*

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.*

- CSTE01L** ☐ Seitenpelot gepolstert, inkl. Befestigung, Links *
- ☐ Neopren: Schwarz
- ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CSTE01R** ☐ Seitenpelot gepolstert, inkl. Befestigung, Rechts *
- ☐ Neopren: Schwarz
- ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CGOR02** ☐ Beckengurt

Länge des Beckengurt (cm):

Bemerkungen:

Beinschutz

▫ *Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Plätalon, geeignet für Dekubitus.*

▫ *Eigenschaften von Plätalon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett.*

- CKUI01** ☐ Verstellbares Wadenband, **Neopren**
- CKUI02** ☐ Wadenschutz auf Rohr
- ☐ Neopren: Schwarz
- ☐ Plätalon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CKUI03** ☐ Verstellbares Wadenband, **bisonyl**

Bemerkungen:

Edelstahl Toiletten-Eimer/Bettpfanne Steckschienen

CTOO07 ☐ Steckschienen Toiletten-Eimer/Bettpfanne Ø 30 cm

Bemerkungen:

Bettpfanne / Toiletteneimer

◦ Für die Darmspülung empfiehlt es sich, wegen des Wassers einen Toiletteneimer zu wählen.

CTOO08 ☐ Toiletten-Eimer mit Kunststoffdeckel Junior XS

Bemerkungen:

Sonstiges Zubehör

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf.*

CTOO01SP ☐ Urin Aufkantung (bisonyl) *


CTAF01 ☐ Tischplatte transparent mit Zubehör *

CBED01 ☐ Betthaken und Empfänger

Bemerkungen:

RÜCKENLEHNEPOLSTERUNG

Rückenlehnepolsterung

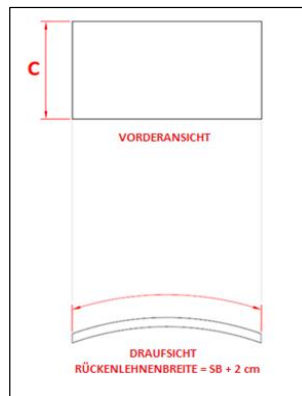


Rückenlehnepolsterung	
C:	

(mindestens 15 cm, maximal 40 cm)

Achtung:

- Bei gepolsterter Rückenlehne reduziert sich die effektive Sitztiefe um 3 cm.
- Eine gepolsterte Rückenlehne ist 2 cm breiter als der Rückenlehnenbügel und Sitzbreite. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Ausfüllen der folgenden Tabellen.

Rückenlehnepolsterung mit maßgefertigte Seitenhalt

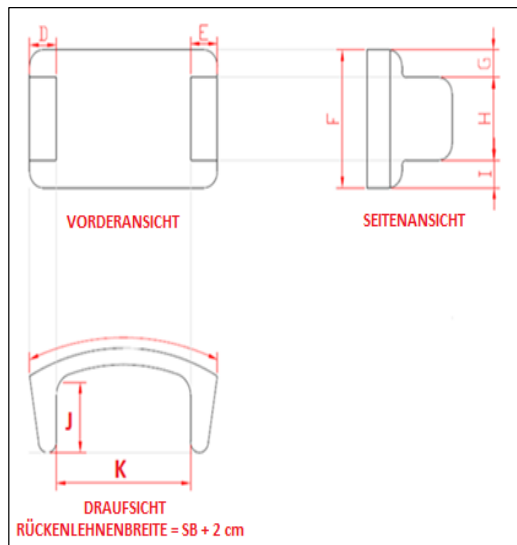

Rückenlehnepolsterung mit maßgefertigte Seitenhalt	
D _{rechts} :	
E _{links} :	
F:	
G _{rechts} :	
G _{links} :	
H _{rechts} :	
H _{links} :	
I _{rechts} :	
I _{links} :	
J _{rechts} :	
J _{links} :	
K:	


ARMSTÜTZEN

Type Armstützen

Type Armstützen: extra verstärkte, einfach gebogen & horizontale Biegung vorne.


Extra verstärkt

Höhe AH: nach Maß




Einfach gebogen

Höhe: nach Maß




Extra verstärkt

Länge AL: nach Maß
Standard extra verstärkt: 32 cm



Einfach gebogen

Länge AL: nach Maß
Standard einfach gebogen: 32 cm
Standard Junior einfach gebogen: 24 cm




Horizontale Biegung vorne : nach Maß

Beispiel einer linken Armlehne mit horizontaler vorderer Biegung.

Höhe AH: nach Maß

Länge AL: nach Maß

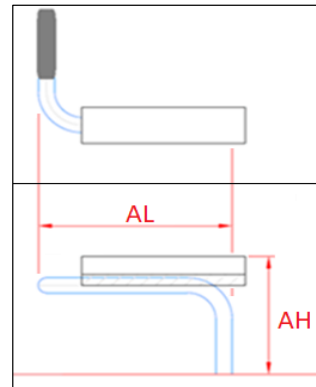

AH - Armstütze nach Maß, höhe (cm)

Extra verstärkt:	
Einfach gebogen:	
Vorderer Biegung:	


AL - Armstütze nach Maß, länge (cm)

Extra verstärkt:	
Einfach gebogen:	
Vorderer Biegung:	

Type Armlehne

Type Armlehne: PU & gepolstert

PU Armlehne




Länge: 25 cm (standard)


Achtung:

Die PU-Armlehnen sind in einer Standardgröße von 25 cm erhältlich. Wenn eine andere Größe benötigt wird, wählen Sie eine gepolsterte Armlehne. Die Armlehnen können auf die extra starken Armlehnen, die Armlehnen mit einfacher Biegung und die Armlehnen mit Biegung befestigt werden. Tragen Sie die erforderlichen Maße in die Tabelle am Ende dieses Dokuments ein.


Armlehnepolsterung

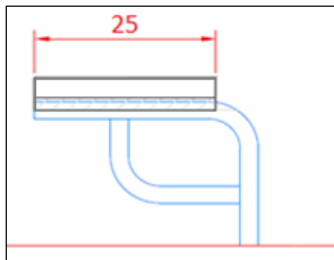


Länge: 25 cm

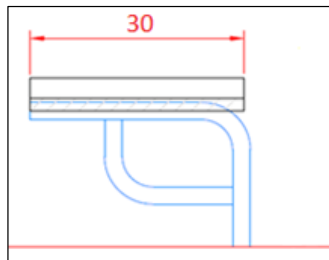


Länge: 30 cm
5 cm nach hinten verlängert

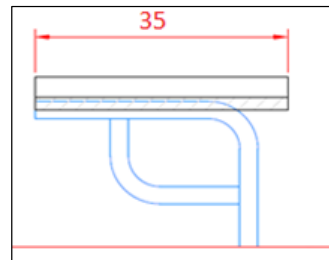


Länge: 35 cm
10 cm nach hinten verlängert

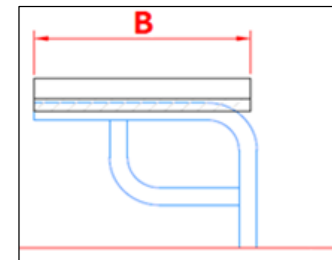


Länge: nach Maß

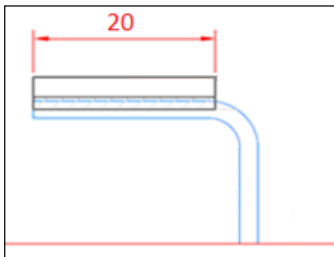

Junior modell
Länge 20 cm

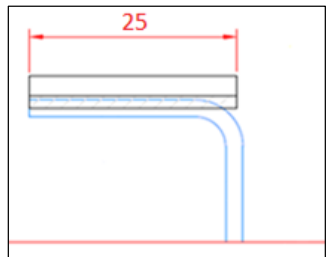

Junior modell
Länge: 25 cm
5 cm nach hinten verlängert

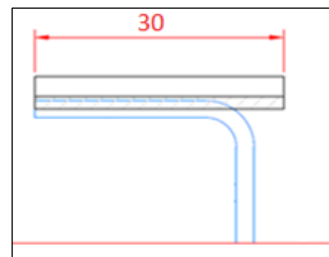


Junior modell
Länge: 30 cm
10 cm nach hinten verlängert

Achtung:

Junior-Armlehnen sind niedriger und kürzer als die extra starken Armlehnen und Armlehnen mit einer Biegung. Beachten Sie dies bei der Wahl der Armlehnenlänge.


Armlehnebreite (C1) ist standard 6 cm

Beispiel: Armlehne vorne gebogen: links (Junior-Modell)

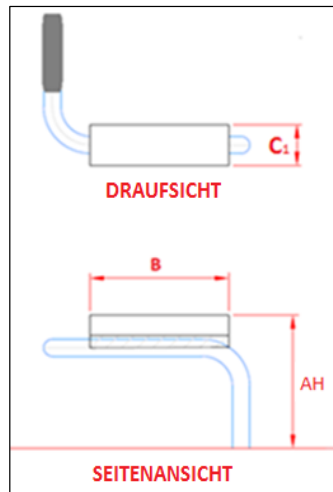

Armstütze vorderer Biegung


Höhe (AH): 15/18/23/... cm
Länge der Armlehne (B): 20 cm
Breite der Armlehne (C1): 6 cm

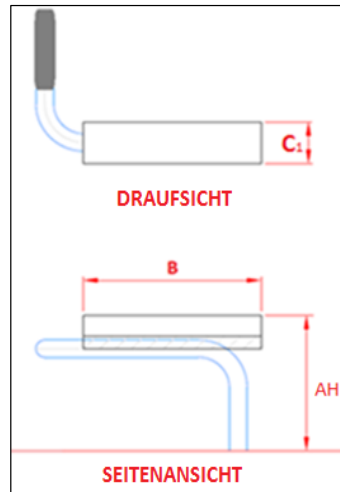

Armstütze vorderer Biegung

Höhe (AH): 15/18/23/... cm
Länge der Armlehne (B): 20 cm
Breite der Armlehne (C1): 6 cm

Armlehnebreite (C1) ist standard.

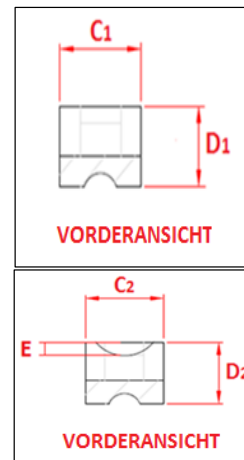

Größen Hemiplegie-Armlehne

Größe Armstütze & Armlehne(cm)	
AH:	Standard 15/18
B:	
C1:	
C2:	
D1:	
D2:	
E:	
Verlängern bis:	

(C1 und C2: mindestens 6 cm, maximal 12 cm)

(D1: mindestens 4 cm, maximal 10 cm)

(D2 = E + mindestens 4 cm)

SONSTIGE ZUBEHÖR

Urin Spritzschutz

Ein Spritzschutz ist aus Bisynt. Dieser wird unter dem Sitz montiert. Geben Sie unten die Breite und Höhe des Spritzschutzes ein.

Größe in cm

Höhe	
Breite	

Tischplatte

Unter der Armlehne wird eine Tischplatte mittels Aufnahmerohr montiert und mit einem Sterngriff fixiert. Geben Sie unten an, zu welcher Seite die Tischplatte weggeklappt werden kann. Geben Sie dann auch die Maße der Tischplatte und der Bauchaussparung an.

- ☐ Nach Links klappbar
☐ Nach Rechts klappbar

Größe in cm

Gesamtbreite	
Gesamttiefe	
Bauchaussparung	

Die minimale Gesamtbreite der Tischplatte ist Sitzbreite + 10 cm.

Die maximale Tiefe der Tischplatte beträgt 60 cm.

Bauchraum: Messen Sie von der Rückseite der Tischplatte bis zur Vorderseite des Bauches.