

Passformular Lagooni Trip / Trip Extra

Dealer	
Berater	
Lieferadresse	
Bezugsnummer	
Telefonnummer	
Email	
Kunde	



Haben Sie Fragen während des Passes?
Rufen Sie uns an unter +31 (0)174-281551

Bitte füllen Sie das Formular möglichst vollständig aus. Bei fehlenden Daten liegt die Verantwortung bei der Partei, die das Formular ausgefüllt hat.

SB: Sitzbreite

SH: Sitzhöhe

ST: Sitztiefe

USL: Unterschenkelänge

- = Diese Teile werden ausgewählt, wenn eine Basiskonfiguration vorgenommen werden muss.

Rahmen

Wählen Sie 1 Rahmentyp aus, verwenden Sie das Flussdiagramm-Modellauswahltool, wenn die Auswahl des Rahmentyps nicht klar ist.

• Rahmen Trip: abgesenkter Rahmen.

• Rahmen Trip Extra: abgesenkter und extra breiter Rahmen.

• Aufgrund des abgesenkten Rahmens kann der Rahmen in den meisten Fällen nicht über eine Toilettenschüssel fahren.

* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf

- | | | |
|--------|--------------------------|--|
| CFRA06 | ☐ | Rahmen Trip mit Höhe-und Rückenlehnenverstellung |
| CFRA08 | ☐ | Rahmen Trip Extra mit Höhe-und Rückenlehnenverstellung |
| AFRA11 | ☐ | Andere Rahmenfarbe |
| CFRA04 | ☐ | Sonderbau Rahmen * |

Bemerkungen:

Räder

• Bei 20"-Zoll-Rädern beträgt der Sitzhöhenbereich: 40 - 55 cm. Die Sitzhöhe wird vom Boden bis zur Oberkante des Sitzes gemessen.

- **CWIE20-100** ☐ 20" XCore Räder und 100 mm Vorderräder
- CWIE24-125** ☐ 24" XCore Räder und 125 mm Vorderräder
- AWIE10** ☐ Demontage Greifreifen
- CWIE02A** ☐ Gummi-überzogener Handlauf 20"
- CWIE02B** ☐ Gummi-überzogener Handlauf 24"
- AWIE11** ☐ Greifreifen fest an den Rädern montiert (nicht möglich für 26" Räder)
- CWIE12** ☐ Greifreifen mit Tetranops
- CWIE12L** ☐ Greifreifen mit Tetranops, links
- CWIE12R** ☐ Greifreifen mit Tetranops, rechts

Bemerkungen:

Bremsen

- **CREM01SET** ☐ Kniehebelbremsen
- CREM02SET** ☐ Bremsen verlängert
- CREM06SET** ☐ Scherebremsen

Bemerkungen:


Sitz

- **Breite Lagooni Trip** : 40 / 42 / 44 / 46 cm
- **Breite Lagooni Trip Extra** : 48 / 50 / 52 / 54 cm
- **Standard dicke des Sitzes Lagooni Trip**: 8 cm (mindestens 6 cm).
- **Standard dicke des Sitzes Lagooni Trip Extra**: 10 cm (mindestens 8 cm).
- **Eigenschaften von Neopren**: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus.
- **Eigenschaften von Platilon**: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett
- * Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf


- **CZIT01** ☐ Sitz mit Polyethern und **Neopren oder Platilon ***
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CZIT07** ☐ Füllstück des Sitzes
- CZIT08** ☐ Beinabduktion nach Maß *
- AZIT01E** ☐ Zusätzliche Anpassungen des Sitzes *

Beispiele


Ausschnitt Vorne/Hinter
Form: Konisch




Ausschnitt Vorne/Hinter
Form: Schlüsselloch




Ausschnitt Vorne/Hinter
Form: gerader Schlitz




Ausschnitt Mitte/anders
Form: Oval



Ausschnitt Links/Rechts
Form: Oval



Ausschnitt Vorne
Form: Ellipse



Geben Sie unten die **Maße (cm)** der Aussparung an. Ein Ausschnitt auf der linken oder rechten Seite ist gegen Aufpreis möglich. Weicht die Lage/Form (z. B. Sitzkeil) von den untenstehenden Beispielen ab, fügen Sie bitte eine Maßzeichnung bei.

Die Felder mit einem * sind **ERFORDERLICH**.

* A:	
* B:	
* C:	
* D:	
* E:	
F:	
* Lage der Aussparung:	
* Form der Aussparung:	

(<7 cm nicht möglich)

Bemerkungen:

Rückenlehnenrohr

- Die Breite des Rückenlehnenbügels entspricht der Breite der Sitzfläche.
- Die Standardhöhe eines Rückenlehnenbügels beträgt 48 cm.

- **CRUG01** ☐ Rückenlehnenbügel
- CRUG01-M** ☐ Rückenlehnenbügel nach Maß *

Bemerkungen:

Rückenlehne Bezug

- Die Standardhöhe eines Rückenlehnenbezugs beträgt 30 cm.
- Bei Wahl einer gepolsterten Rückenlehne gilt: Sitztiefe + 3 cm.
- Bei einer „normalen“ gepolsterten Rückenlehne gilt: Breite der gepolsterten Rückenlehne = Rückenlehnenbügel + 2 cm.
- Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus.
- Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett
- * Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf

- **CRUG12** ☐ Rückenlehne Segeltuch bisonyl schwarz
- CRUG01B** ☐ Rückenlehne gepolstert mit Polyethern und **Neopren oder Platilon** *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CRUG01BZUJ** ☐ Rückenlehne mit Seitenpelotte gepolstert mit Polyethern und **Neopren oder Platilon** *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CRUG01K** ☐ Rückenlehne gepolstert Schalenform gepolstert mit Polyethern und **Neopren oder Platilon** *
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau

Bemerkungen:

Armstütze

▫ Die Armstütze sind wegschwenkbar und abnehmbar.

▫ Die Höhe der Armstütze wird von der Oberkante des Sitzes bis zur Oberkante der Armlehne gemessen.

▫ Für kürzere und niedrigere Armstütze können Sie sich für eine Junior-Armstütze (siehe Registerkarte "Maßblatt") oder eine Armstütze entscheiden, die nach Maß angefertigt werden muss.

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf*

- | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| CARM03-15 | ☐ | Junior Armstütze gerade, H15 cm |
| CARM03-18 | ☐ | Junior armstütze gerade, H18 cm |
| • CARM01 | ☐ | Armstütze einfach gebogen H23 cm |
| • CARM02 | ☐ | Armstütze verstärkt H23 cm |
| CARM04 | ☐ | Armstütze nach Maß* |
| CARM09 | ☐ | Armstütze horizontale biegun vorne |
| AARM02E | ☐ | Zusätzliche Arbeit der Armstütze * |
| - | ☐ | Keine Armstütze |

Bemerkungen:

Armlehne

▫ Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Plätalon, geeignet für Dekubitus.

▫ Eigenschaften von Plätalon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf*

- | | | |
|-----------------|--------------------------|---|
| • CARM05 | ☐ | Armlehne PU |
| CARM06 | ☐ | Armlehnepolsterung mit Polyethern und Neopren oder plätalon * |
| | ☐ | Neopren: Schwarz |
| | ☐ | Plätalon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau |
| AARM06E | ☐ | Zusätzliche Arbeit der Armlehne* |
| - | ☐ | Keine Armlehne |

Bemerkungen:

Beinstützen und Fußstützen

» Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutscher als Platon, geeignet für Dekubitus.

» Eigenschaften von Platon: stark, rutscher als Neopren, geeignet für Rutschbrett

* Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf

- - ☐ Keine Beinstützen und/oder Fußstützen
- CBE01SET** ☐ Wegschwenkbare Beinstützen mit klappbaren Fußstützen
- CBE02SET** ☐ Einstellbare Beinstützen mit klappbaren Fußstützen
- CBE04SET** ☐ Einstellbare Oberbeinunterstützung (für die Amputation)
- CVOE03** ☐ Einstück Fußbrett, gepolstert (montage Fußbretthalterung mit Klemmen)
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CVOE04B** ☐ Polsterung Einstück Fußbrett **TRIP**
- zusammen mit Wegschwenkbare Beinstützen
 - ☐ Montage auf Fußbrett, klappbar nach rechts
 - ☐ Montage auf Fußbrett, klappbar nach links
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CVOE04B** ☐ Polsterung Einstück Fußbrett **TRIP EXTRA (EXTRA BREIT)**
- zusammen mit Wegschwenkbare Beinstützen
 - ☐ Montage auf Fußbrett, klappbar nach rechts
 - ☐ Montage auf Fußbrett, klappbar nach links
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CVOE09** ☐ Polsterung zweiteilige Fußstützen **TRIP**
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CVOE09** ☐ Polsterung zweiteilige Fußstützen **TRIP EXTRA**
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- AVOE01E** ☐ Zusätzliche Anpassungen der Fußstützpolsterung *

Bemerkungen:

Kopfstütze

» Wird eine Kopfstütze gewählt, empfiehlt sich die Wahl einer gepolsterten Rückenlehne.

» Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutscher als Platon, geeignet für Dekubitus.

» Eigenschaften von Platon: stark, rutscher als Neopren, geeignet für Rutschbrett

- CSTE02** ☐ Kopfstütze gepolstert **neopren oder platon**
 - ☐ Neopren: Schwarz
 - ☐ Platon: Schwarz/ matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CSTE03K** ☐ Kopfstütze PU **Klein**
- CSTE03MG** ☐ Kopfstütze PU **Mittelgroß**

Bemerkungen:

Seitliche Unterstützung

» Beckengurtlänge: vom linken Einstellknopf für den Rückenwinkel bis zum rechten Einstellknopf für den Rückenwinkel.

» Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus.

» Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf*

- CSTE01L** ☐ Seitenpelot gepolstert, inkl. Befestigung, Links *
- ☐ Neopren: Schwarz
- ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CSTE01R** ☐ Seitenpelot gepolstert, inkl. Befestigung, Rechts *
- ☐ Neopren: Schwarz
- ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CGOR02** ☐ Beckengurt

Länge des Beckengurt (cm):

Bemerkungen:

Beinschutz

» Eigenschaften von Neopren: weich, wenig rutschiger als Platilon, geeignet für Dekubitus.

» Eigenschaften von Platilon: stark, rutschiger als Neopren, geeignet für Rutschbrett

- CKUI01** ☐ Verstellbares Wadenband, Neopren
- CKUI02** ☐ Wadenschutz auf Rohr
- ☐ Neopren: Schwarz
- ☐ Platilon: Schwarz / matt grau / ferrari rot / hellblau / marine blau
- CKUI03** ☐ Verstellbares Wadenband, bisonyl

Bemerkungen:

Edelstahl Toiletten-Eimer/Bettpfanne Steckschienen

» Schienen ragen 3 cm unter dem Sitz hervor. Berücksichtigen Sie dies bei der Bestimmung der Sitzhöhe.

CTOO03 ☐ Steckschienen Toiletten-Eimer/Bettpfanne Ø 30 cm

Bemerkungen:

Bettpfanne / Toiletteneimer

» Für die Darmspülung empfiehlt es sich, wegen des Wassers einen Toiletteneimer zu wählen.

CTOO02 ☐ Edelstahl Bettpfanne mit Deckel

CTOO04 ☐ Edelstahl Toiletten-Eimer mit Deckel

Bemerkungen:

Sonstiges Zubehör

** Bitte listen Sie die erforderlichen Größen auf der Registerkarte "Maßblatt" auf*

CTOO01SP ☐ Urin Aufkantung (bisonyl) *


CTAF01 ☐ Tischplatte transparent mit Zubehör *

CBED01 ☐ Betthaken und Empfänger

Bemerkungen:

Rückenlehnenpolsterung

Rückenlehnenpolsterung

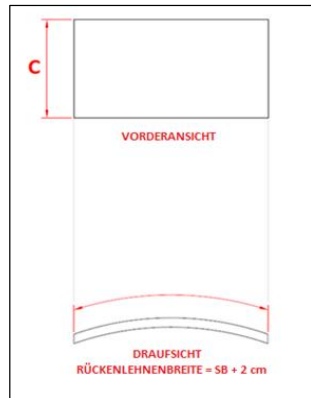


Rückenlehnenpolsterung	
C:	

(mindestens 15 cm, maximal 40 cm)

Achtung:

- Bei gepolsterter Rückenlehne reduziert sich die effektive Sitztiefe um 3 cm.
- Eine gepolsterte Rückenlehne ist 2 cm breiter als der Rückenlehnenbügel und Sitzbreite. Bitte berücksichtigen Sie dies beim Ausfüllen der folgenden Tabellen.

Rückenlehnenpolsterung mit maßgefertigte Seitenhalt

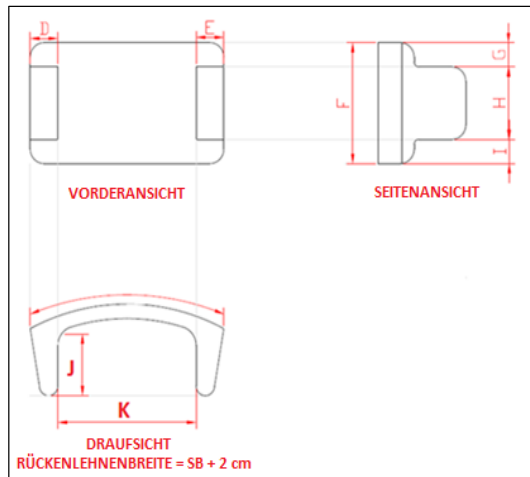

Rückenlehnenpolsterung mit maßgefertigte Seitenhalt	
D _{rechts} :	
E _{links} :	
F:	
G _{rechts} :	
G _{links} :	
H _{rechts} :	
H _{links} :	
I _{rechts} :	
I _{links} :	
J _{rechts} :	
J _{links} :	
K:	


Armstützen

Type Armstützen

Type Armstützen: extra verstärkte, einfach gebogen & horizontale Biegung vorne.


Extra verstärkt

Höhe AH: nach Maß



Einfach gebogen


Höhe: nach Maß

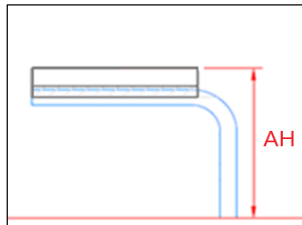

Extra verstärkt

Länge AL: nach Maß

Standard extra verstärkt: 32 cm




Einfach gebogen

Länge AL: nach Maß

Standard einfach gebogen: 32 cm

Standard Junior einfach gebogen: 24 cm

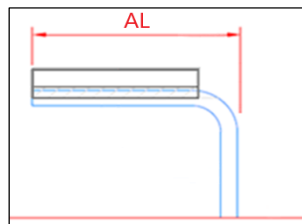


Horizontale Biegung vorne : nach Maß

Beispiel einer linken Armlehne mit horizontaler vorderer Biegung.

Höhe AH: nach Maß

Länge AL: nach Maß

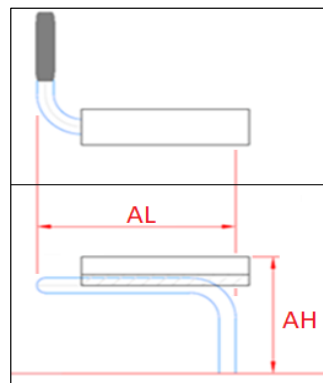

AH - Armstütze nach Maß, höhe (cm)

Extra verstärkt:	
Einfach gebogen:	
Vorderer Biegung:	


AL - Armstütze nach Maß, länge (cm)

Extra verstärkt:	
Einfach gebogen:	
Vorderer Biegung:	

Type Armlehne

Type Armlehne: PU & gepolstert

PU Armlehne




Länge: 25 cm (standard)


Achtung:

Die PU-Armlehnen sind in einer Standardgröße von 25 cm erhältlich. Wenn eine andere Größe benötigt wird, wählen Sie eine gepolsterte Armlehne. Die Armlehnen können auf die extra starken Armlehnen, die Armlehnen mit einfacher Biegung und die Armlehnen mit Biegung befestigt werden. Tragen Sie die erforderlichen Maße in die Tabelle am Ende dieses Dokuments ein.


Armlehnepolsterung

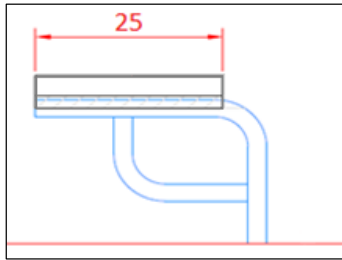


Länge: 25 cm

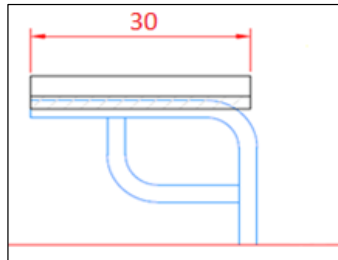


Länge: 30 cm
5 cm nach hinten verlängert

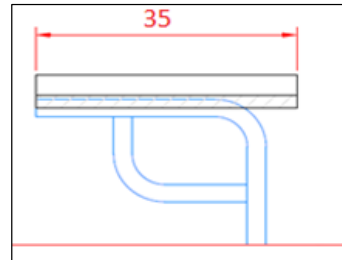


Länge: 35 cm
10 cm nach hinten verlängert

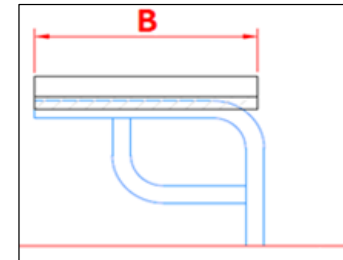


Länge: nach Maß

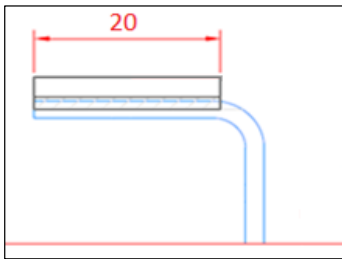

Junior modell
Länge 20 cm

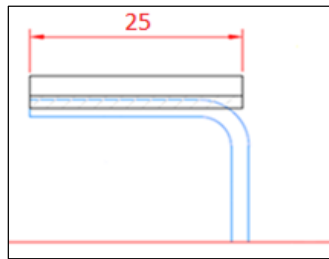

Junior modell
Länge: 25 cm
5 cm nach hinten verlängert

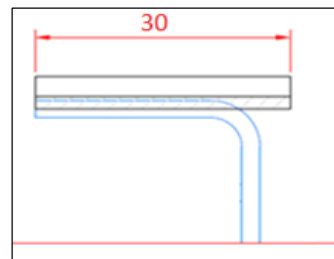



Junior modell
Länge: 30 cm
10 cm nach hinten verlängert

Achtung:

Junior-Armlehnen sind niedriger und kürzer als die extra starken Armlehnen und Armlehnen mit einer Biegung. Beachten Sie dies bei der Wahl der Armlehnenlänge.

Armlehnebreite (C1) ist standard 6 cm

Beispiel: Armlehne vorne gebogen: links (Junior-Modell)

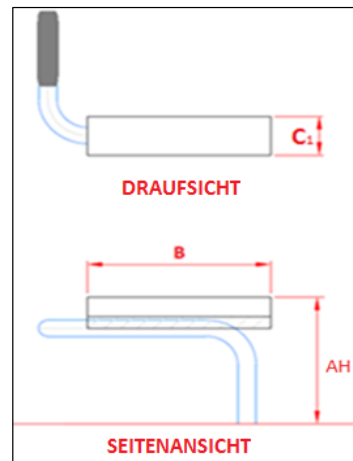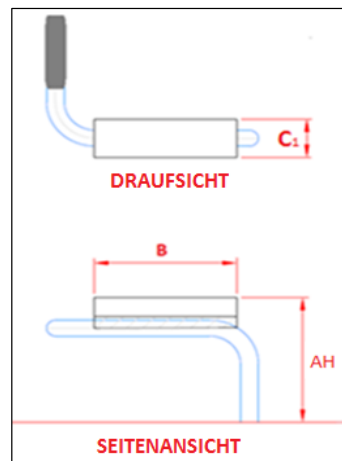



Armstütze vorderer Biegung

Höhe (AH): 15/18/23/... cm
Länge der Armlehne (B): 20 cm
Breite der Armlehne (C1): 6 cm

Armstütze vorderer Biegung

Höhe (AH): 15/18/23/... cm
Länge der Armlehne (B): 20 cm
Breite der Armlehne (C1): 6 cm

Armlehnebreite (C1) ist standard.



Größen Hemiplegie-Armlehne

Größe Armstütze & Armlehne(cm)	
A:	Standard 23
B:	
C1:	
C2:	
D1:	
D2:	
E:	
Verlängern bis:	

(C1 und C2: mindestens 6 cm, maximal 12 cm)

(D1: mindestens 4 cm, maximal 10 cm)

(D2 = E + mindestens 4 cm)

Sonstige Zubehör

Urin Spritzschutz

Ein Spritzschutz ist aus Bisonyl. Dieser wird unter dem Sitz montiert. Geben Sie unten die Breite und Höhe des Spritzschutzes ein.

Größe in cm

Höhe	
Breite	

Tischplatte

Unter der Armlehne wird eine Tischplatte mittels Aufnahmerohr montiert und mit einem Sterngriff fixiert. Geben Sie unten an, zu welcher Seite die Tischplatte weggeklappt werden kann. Geben Sie dann auch die Maße der Tischplatte und der Bauchaussparung an.

- ☐ Nach Links klappbar
☐ Nach Rechts klappbar

Größe in cm

Gesamtbreite	
Gesamttiefe	
Bauchaussparung	

Die minimale Gesamtbreite der Tischplatte ist Sitzbreite + 10 cm.

Die maximale Tiefe der Tischplatte beträgt 60 cm.

Bauchraum: Messen Sie von der Rückseite der Tischplatte bis zur Vorderseite des Bauches.